

**LEGENDE**


- Durchsichtsfenster bzw. Verglasung in der Türe
- Motorantrieb f. Türen, Bedienung (falls nicht anders angegeben) über Taster u. bzw. oder Wandstoss-Schalter in d. Zargen
- Betätigung der Automatikturen mit Schlagleisten und Druckknöpfen auf der Zarge
- ARS** Ausseröffstore ARS80
- Rb.** Wandeinbau-Röntgenfilmbetrachter Typ DX 120x43 Einbaumass : 1400x625x102mm, UK.=+1200mm ab OK.FFB.
- Wanduhr d=300mm, +2300mm ab OK.FFB.
- ET.1** Wandeinbau-Tableau BxHxT ca.500x500x120mm UK.= +1200mm ab OK.FFB.
- IR** IR-Wandtableau f. OP-Tisch, BxHxT 393x180x120mm
- Ms.** Motorsteuerkasten f. OP-Tisch, BxHxT 500x550x150mm
- UV.** Unterverteiler, UK.=+850mm ab OK.FFB.  
- UV3 BxHxT 550x1100x140mm  
- UV4 BxHxT 300x1100x140mm
- DVE.-An.** Deckenversorgungseinheit Anästhesie, Deckenverankerungsring
- DVE.-Ch.** Deckenversorgungseinheit Chirurgie, Deckenverankerungsring

- OPL.** OP-Leuchte, Deckenverankerungsring
- OPT.** Bodeneinbauplatte f. OP-Tischsäule
- VK.** Ventil-Kontrollkasten Einbaumass ca. 535x275x120mm UK. = +1600mm ab OK.FFB.
- KuFe/DK.** Kunststoff-Fenster, Drehkippbeschlag, Scheibe n. Angabe
- KuFe/FF.** Kunststoff-Fenster, feststehend (Innen.-bzw. Aussenfenster)
- Wandschutzleisten: Vollkernkunststoff Fabr. Max, Farbe 85 FH 250 mm hoch, UK.=+400 mm ab OK.FFB.
- Eckschutzleiste V2A, raumhoch
- Türdrückergarnitur, Drücker/feststehender Knopf
- Türdrückergarnitur, Panikdrücker/feststehender Knopf
- UZ.** Unterzug nach Statik
- Flusenabscheider in den Luftabsaugschächten genaue Lage u. Grösse siehe Zeichn. Fa. KKT
- LS.** Luftabsaugschächte
- Blitzschutz-Anschlussfahne
- Wandverstärkung für wandhängende Lasten UK. = +.....mm, OK.= +.....mm ab OK.FFB.
- Raumventilierung
- Türunterschneidung ca. 15mm

- Entnahmestelle Sauerstoff (O<sub>2</sub>)
- Entnahmestelle Druckluft 5bar (DR5)
- Entnahmestelle Druckluft 8bar (DR8)
- Entnahmestelle Vakuum (VA)
- Entnahmestelle Narkosegas (N<sub>2</sub>O)
- Kupplung-Narkosegasabsaugung

Lage und Grösse der Durchbrüche sowie Revisionsöffnungen der Klimaanlage siehe Zeichn. Fa. KKT

Wandansicht: Anästhesie-Arbeitsplatz (M 1:25)

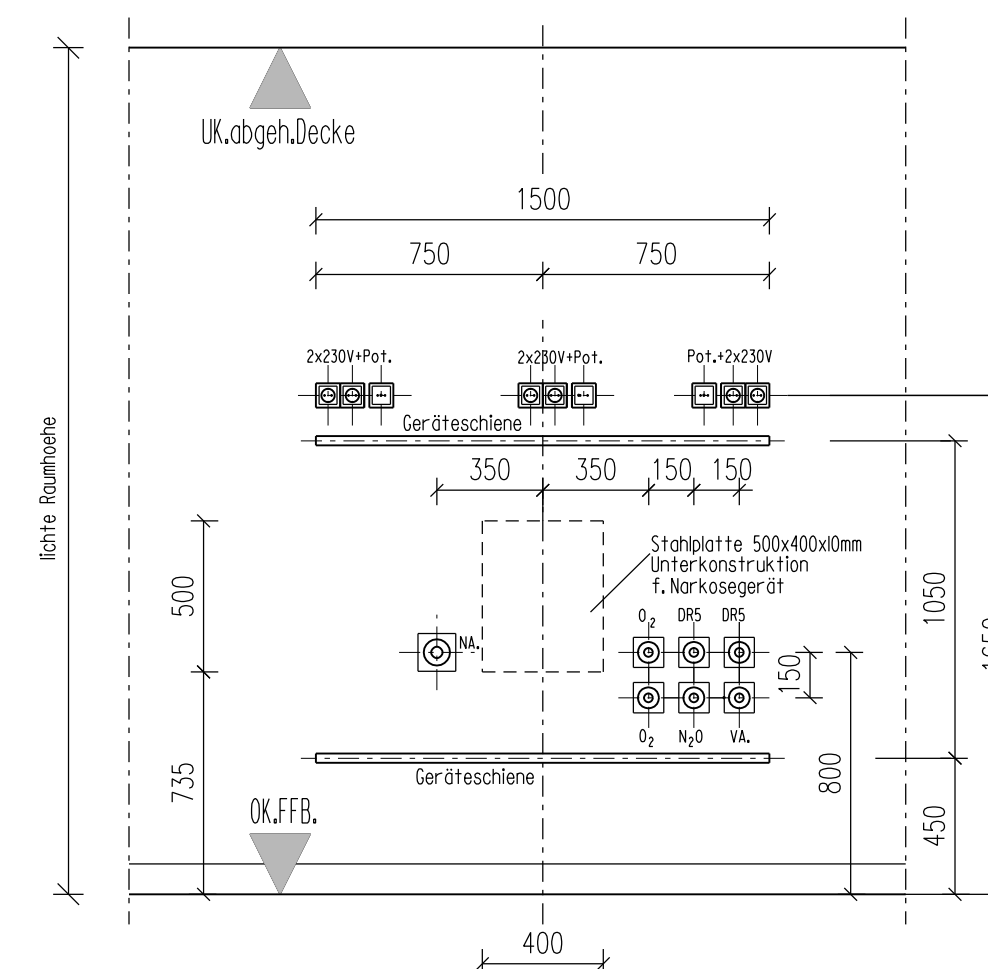

|                |  |  |                   |
|----------------|--|--|-------------------|
| b              | geändert z. Pl. Stand vom 12.02.03.        | Sf   | 10.03.2003        |
| a              | Geändert nach Planstand vom 03.12.02       | Mo   | 10.03.2003        |
| Ind.           | Änderung                                   | Name   | Datum             |
| <b>cado to</b> |  | <b>Cadolto Thüringen GmbH</b><br>An der Bahn 2<br>D-07357 Krippa<br>Tel. (03947) 4345-0 Fax (03947) 413639 |                   |
| Typ:           | <b>RZ</b>                                  | Name:  |                   |
| Bauvorhaben:   | <b>Cadolto Standard-OP RZ 14,0 x 5,0 m</b> | gezeichnet:  | <b>Pe</b>         |
| geprüft:       |  | Datum:   | <b>10.03.2003</b> |
| Planinhalt:    | <b>Grundrissplan</b>                       | Maßstab:   | <b>1 : 25</b>     |
| Dat:           | <b>SFILES</b>                              |  | <b>wa001</b>      |

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und darf in keinem Fall ohne besondere Genehmigung ververvielfältigt, abgedruckt, nach einem Reproduktionssystem in digitaler oder in Kopie mitgeteilt werden, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.